


# Neotech RAM Cannula<sup>®</sup>

## CANULE NASALE À OXYGÈNE

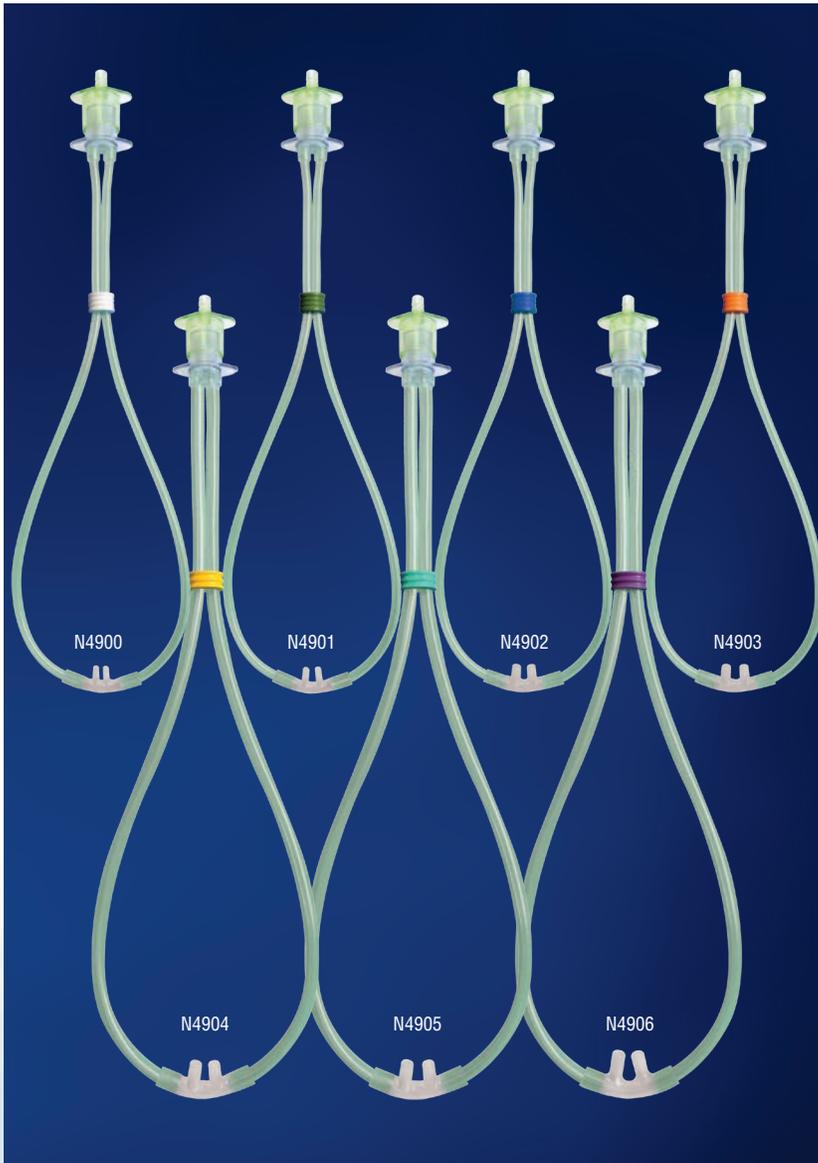

### FONCTIONS ET AVANTAGES

- Produit destiné à une utilisation avec de l'oxygène humidifié faible ou haut débit
- Embouts nasaux souples et courbes
- Tailles à code-couleur
- Adaptateur pour le tube d'oxygène de 15 mm inclus
- N'est pas fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel ou de plastifiant DEHP
- Emballage individuel

Catalogue	Objet	Quantité/Unité
N4900	Blanc	10/boîte
N4901	Verte	10/boîte
N4902	Bleue	10/boîte
N4903	Orange	10/boîte
N4904	Jaune	10/boîte
N4905	Sarcelle	10/boîte
N4906	Violet	10/boîte
N4820	Adaptateur de tube d'oxygène	50/boîte



Le clinicien  
a inventé



Fabriqué  
aux États-Unis

Brevet #8,353,296; #D681,193; #9,027,562; #9,808,593;  
#9,861,777; Brevets étrangers supplémentaires en instance

# Neotech RAM Cannula®

## CANULE NASALE À OXYGÈNE

### INDICATIONS D'UTILISATION

La canule Neotech RAM est prévue pour une utilisation avec les nouveaux-nés prématurés ou à terme, les nourrissons et les patients en pédiatrie nécessitant de l'oxygène supplémentaire ou une assistance respiratoire dans un environnement ambulancier, hospitalier ou institutionnel. Elle est utilisée pour fournir de l'oxygène avec les méthodes suivantes :

1. Oxygène humidifié et chauffé ou non chauffé à bas débit.
2. Oxygène humidifié et chauffé à haut débit.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 Sélectionnez la canule de taille appropriée au moyen du guide de taille RAM fourni. La taille idéale des pinces nasales doit remplir environ 80% des narines. Assurez-vous que les pinces ne remplissent pas complètement les narines.
- 2 Reliez l'adaptateur de tube à oxygène de 15 mm (fourni) à la canule RAM. Reliez la canule à la source d'oxygène. Vérifiez que tous les raccords de la canule soient correctement sécurisés.
- 3 Vérifiez et essayez le débit et la teneur en oxygène avant d'utiliser l'appareil sur le patient.
- 4 Insérez les pinces dans les narines du patient en laissant un petit espace entre la base des pinces et le septum.
- 5 Fixez la canule au visage avec un pansement pour tube et canule EZ-Hold® ou un produit comparable.
- 6 Remplacez la canule Neotech RAM tous les 14 jours ou à la fréquence indiquée par le protocole hospitalier, selon la première éventualité. Jetez la canule RAM usagée par protocole hospitalier.

#### Résistance à l'écoulement

**N4900, N4901, N4902, N4903**

0.446 cmH<sub>2</sub>O / L / min @ 2.5 LPM

**N4904, N4905, N4906**

0.230 cmH<sub>2</sub>O / L / min @ 15 LPM

### CONTRE-INDICATIONS, PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

L'utilisation de la canule Neotech RAM est contre-indiquée pour les patients présentant une atrésie choanale ou des malformations de la structure faciale qui empêchent une assistance respiratoire adéquate.

Selon la loi fédérale, ce dispositif ne peut être vendu que par ou sur ordre d'un médecin.

Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente quando il paziente è sotto supervisione continua e diretta di un operatore sanitario che debba frequentemente osservare la posizione dei rebbi nelle narici del paziente.

La sélection d'une taille inappropriée, le positionnement incorrect ou la mauvaise utilisation de ce produit peuvent provoquer des lésions ou des nécroses du septum.

Le tube de la canule pose un risque potentiel d'étranglement. N'utilisez pas le joint torique pour fixer le dispositif au patient.

Commencez toujours par ouvrir le débit de gaz avant d'insérer les embouts nasaux dans les narines du patient.

N'utilisez pas ce produit si l'emballage est endommagé ou ouvert.

N'essayez pas de tremper, laver ou stériliser ce produit.

Interrompez immédiatement l'utilisation en cas d'irritation de la peau.

À usage unique.



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague  
The Netherlands



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2021 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.

M665 Rev A